



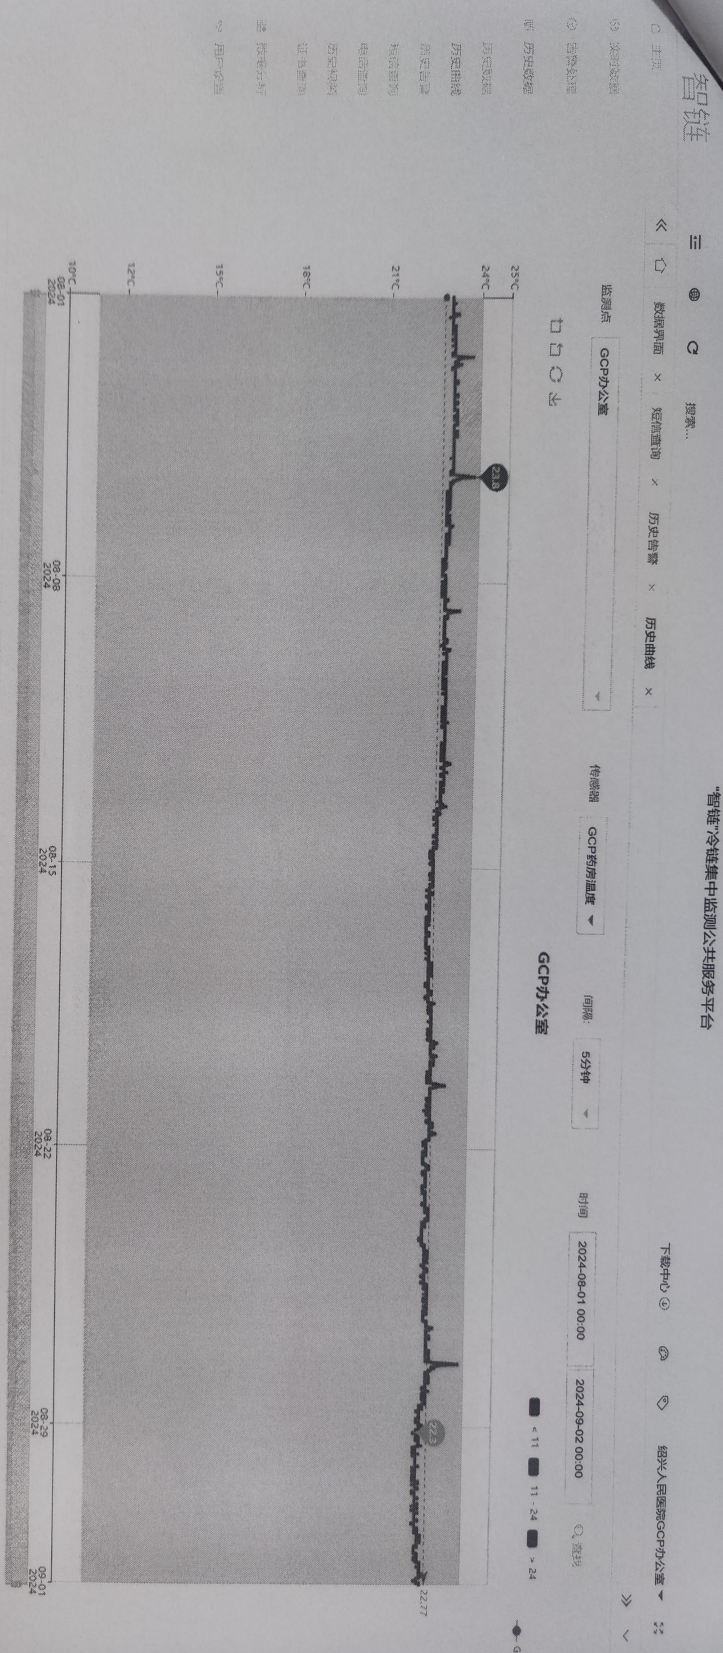

2024.9.2

药房温度

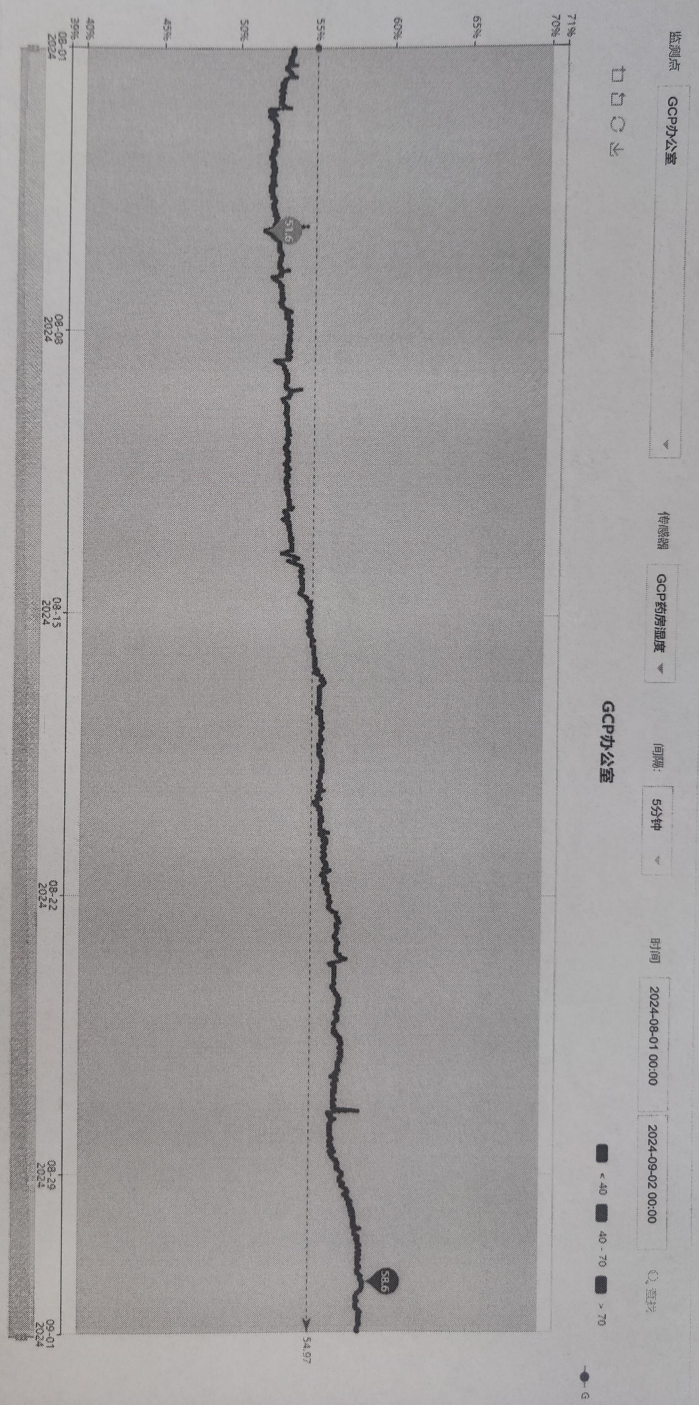

2024/9/2

智链

“智链”冷链集中监测公共服务平台

下载中心 ①

②

③

绍兴人民医院GCP办公室

④ 主页

⑤ 实时数据

⑥ 告警处理

⑦ 历史数据

⑧ 历史报警

⑨ 历史曲线

⑩ 历史报警

⑪ 历史报警

⑫ 历史报警

⑬ 历史报警

⑭ 历史报警

⑮ 用户管理

数据界面 × 短信管理 × 历史报警 × 历史曲线 ×

监测点 GCP办公室

传感器 1号冰箱

周期: 5分钟

时间 2024-08-01 00:00


2024-09-02 00:00

图形

□ □ □ □


GCP办公室

◻ < 3 ◻ 3 ~ 7 ◻ > 7

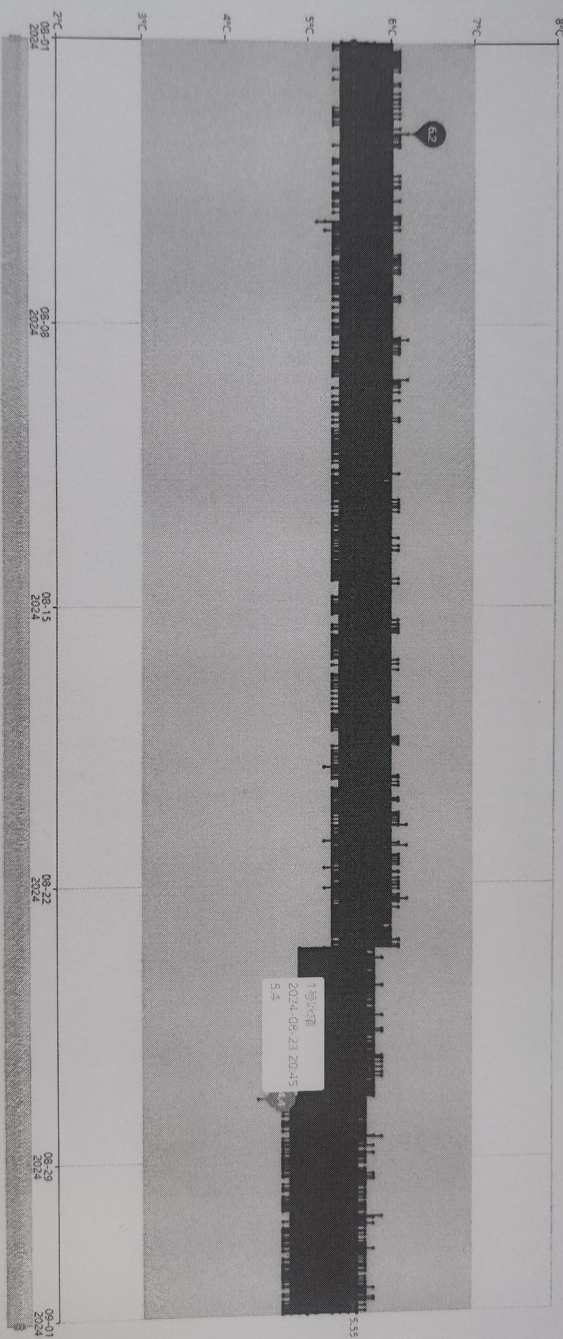

2024.9.2

1 号冰箱



智链

“智链”冷链集中监测公共服务平台

下载中心 ④ ② ③ 绍兴人民医院GCP办公室

主图

④ 实时数据

④ 历史数据

④ 历史报警

④ 历史曲线

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

④ 历史报警

数据界面 × 报警界面 × 历史报警 × 历史曲线 ×

监测点 GCP办公室

传输间隔 3号冰箱

间隔 5分钟

时间 2024-08-01 00:00


2024-09-02 00:00

查找

智链


GCP办公室

< 3 3-7 > 7

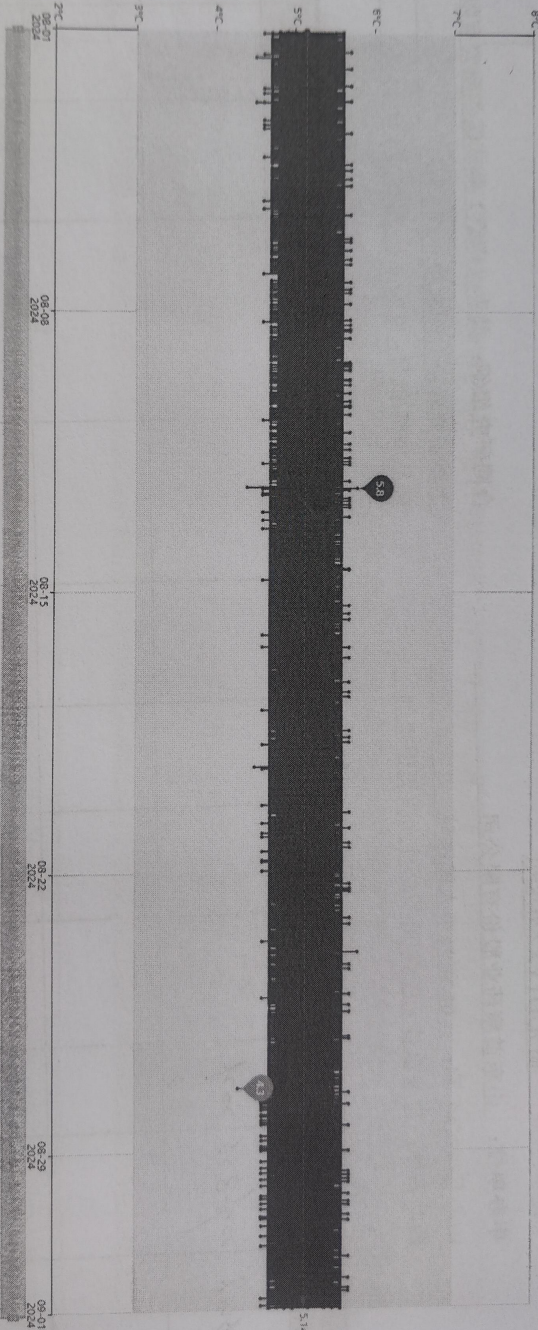

2024.9.2

3号冰箱

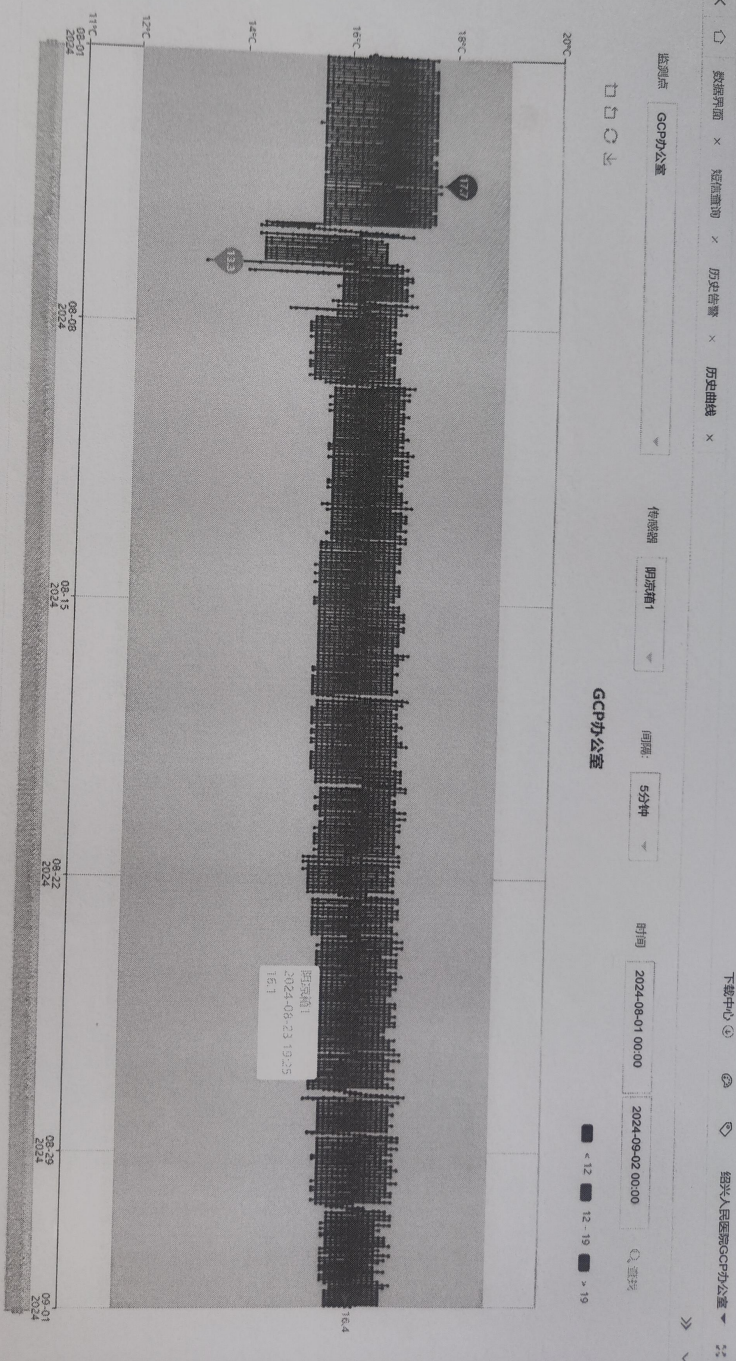

26 June 2007

阴凉柜 1