



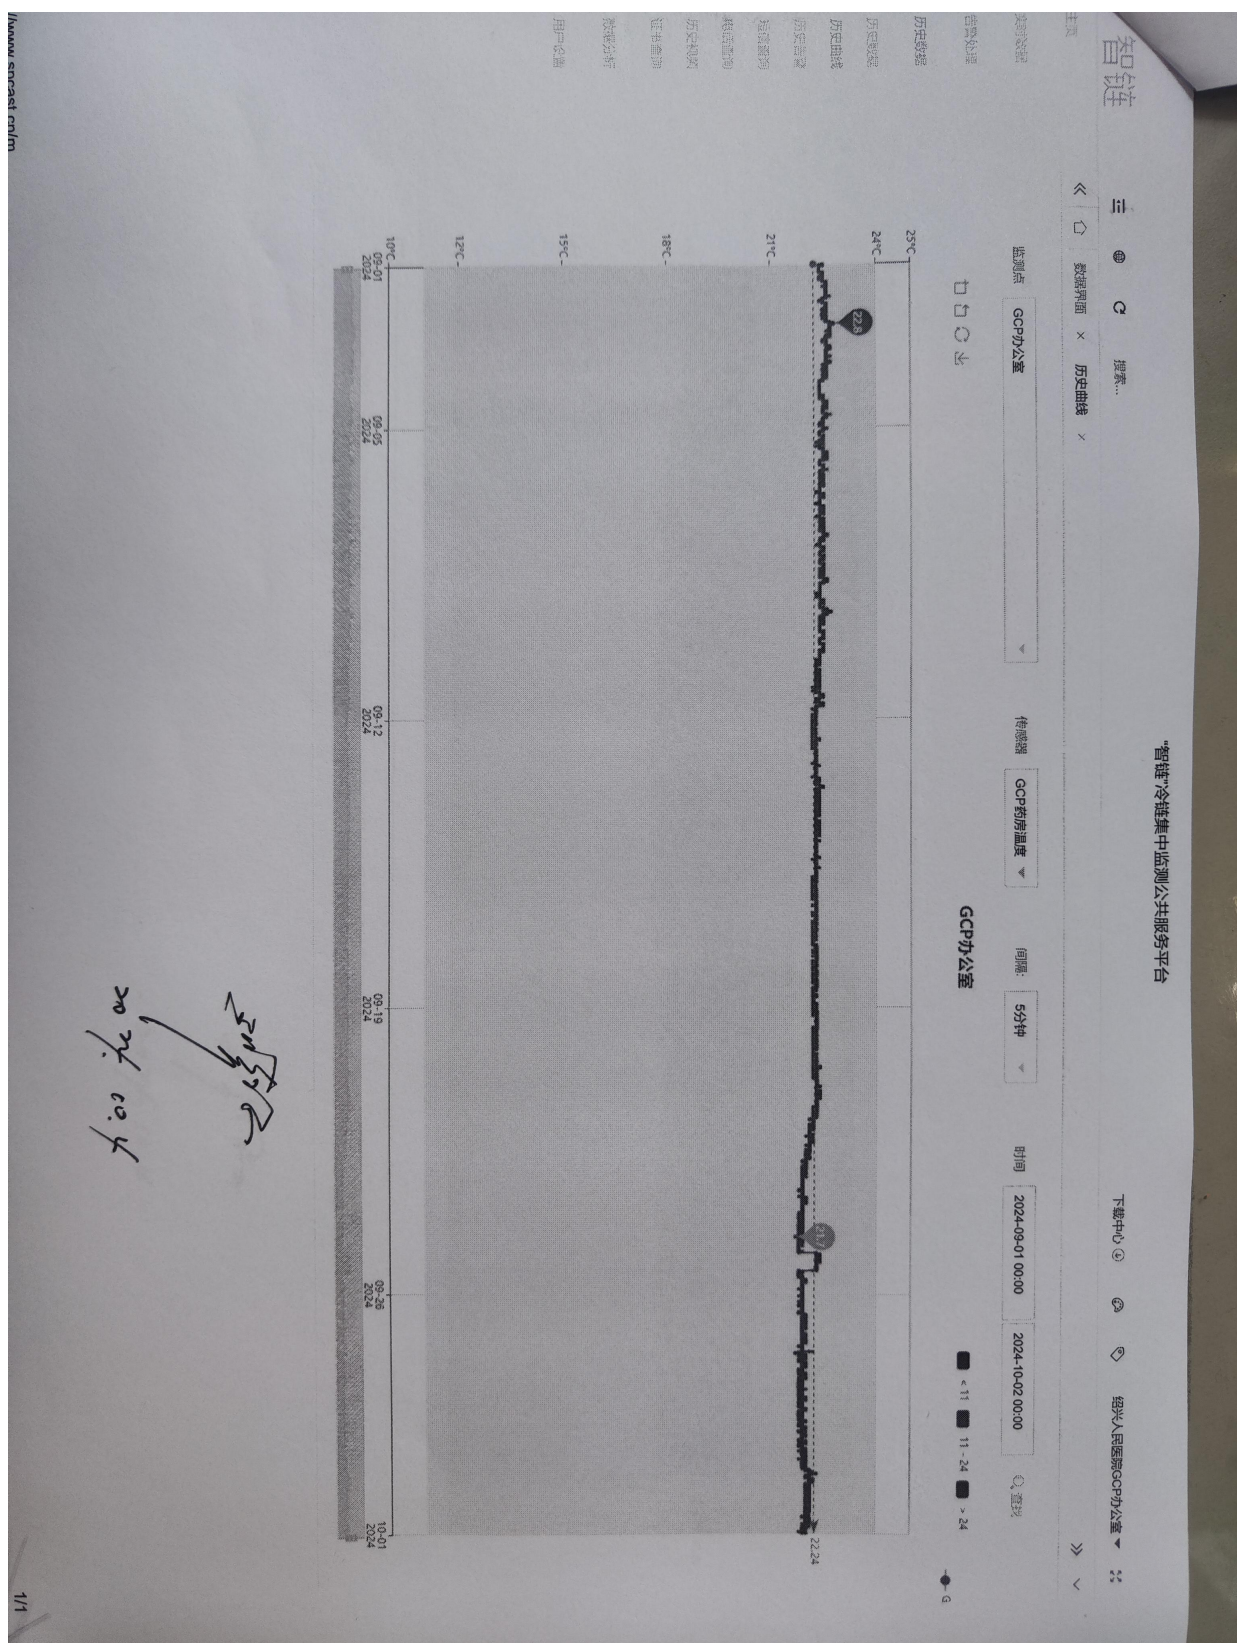

药房温度

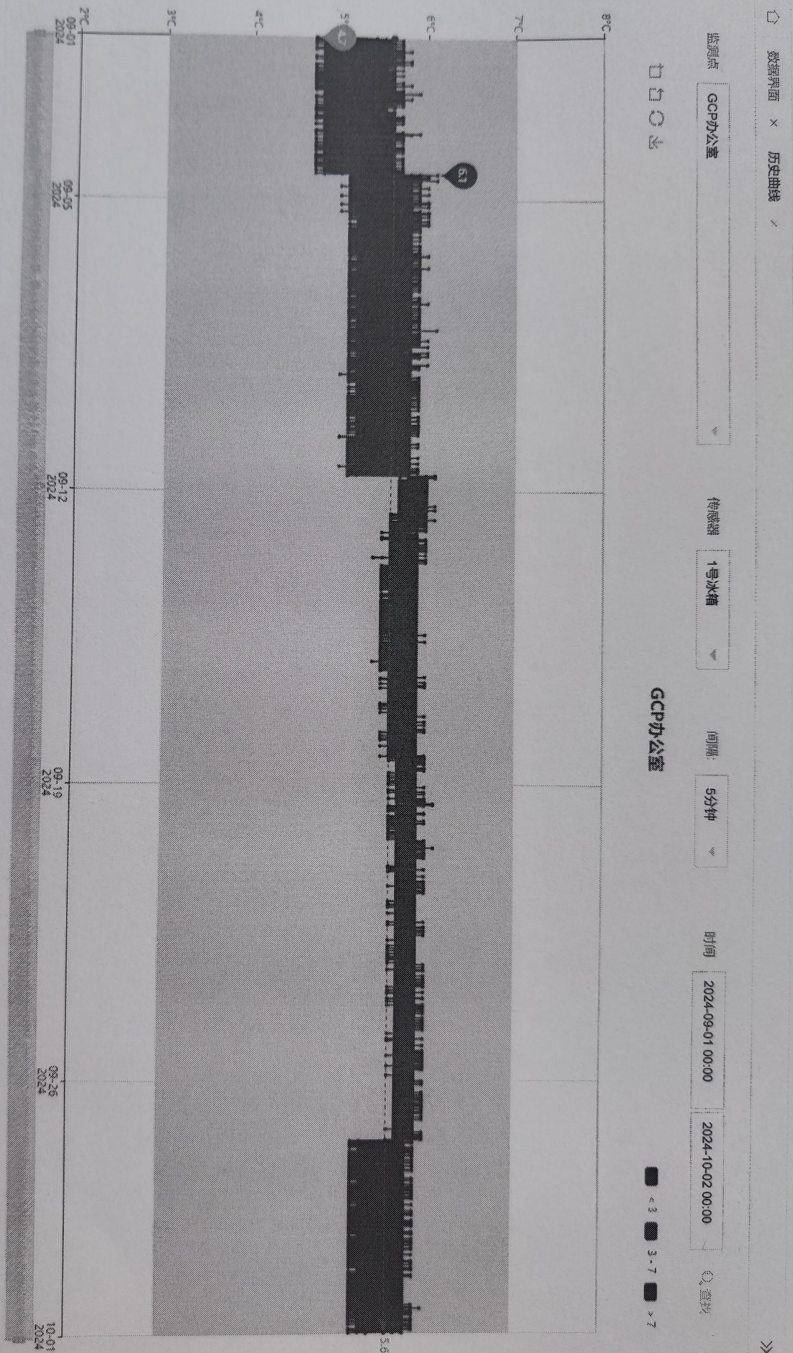

2011/04/10

① 首页

② 数据治理

③ 历史数据

④ 历史曲线

⑤ 历史报警

⑥ 报警处理

⑦ 报警设置

⑧ 报警通知

⑨ 报警通知

⑩ 报警通知

⑪ 报警通知

⑫ 报警通知

数据治理 × 历史曲线 ×

监测点 GCP办公室

传感器 2号冰箱

周期 5分钟


时间 2024-09-01 00:00

2024-10-02 00:00

重绘

GCP办公室

< 2 3-7 > 7

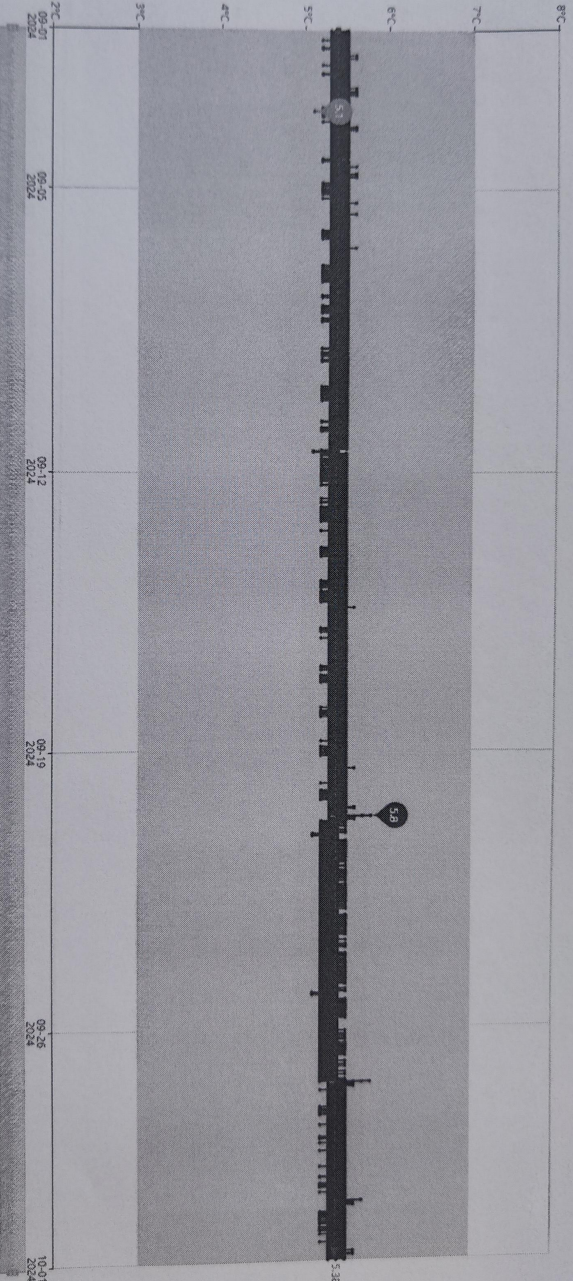

2号冰箱

2 号冰箱

监测点

GCP办公室

3冊水箱


间隔：
5分钟

时间 2024-09-01 00:00

2024-10-02 00:00

◎ 查表

GCP办公室

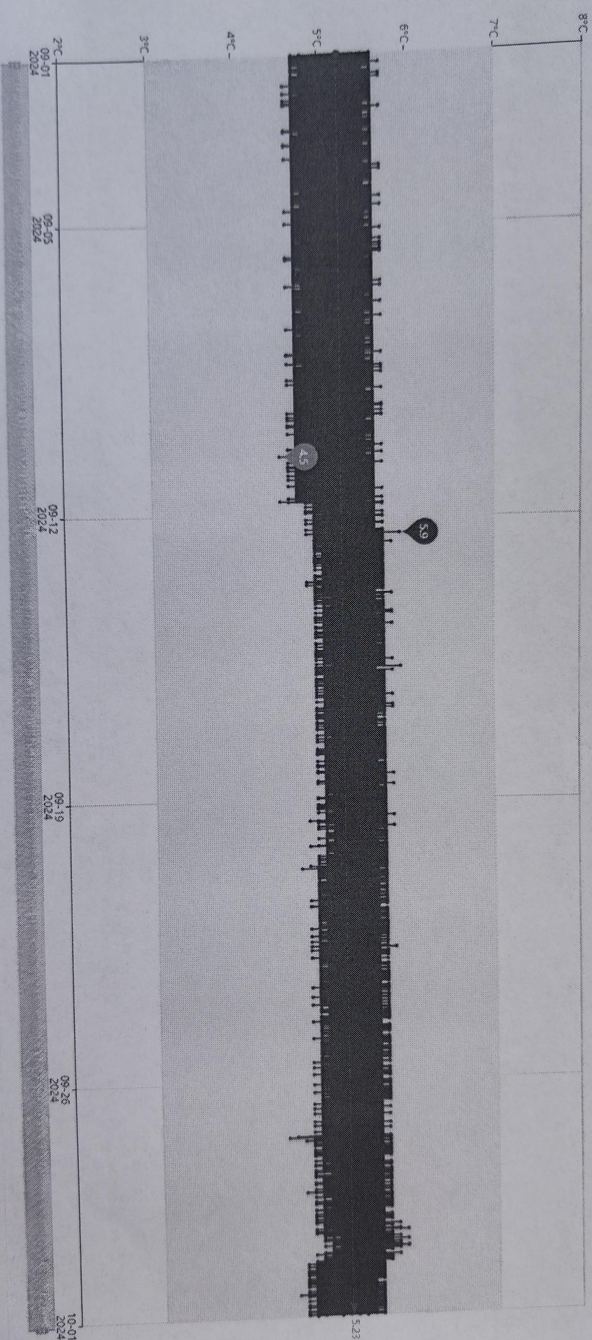

2007.10.14

3 号冰箱

智链

搜索...

2000

历史曲线 × 数据界面 ×

GCP办公室

7

1


22

10

50°C


1997

50C-

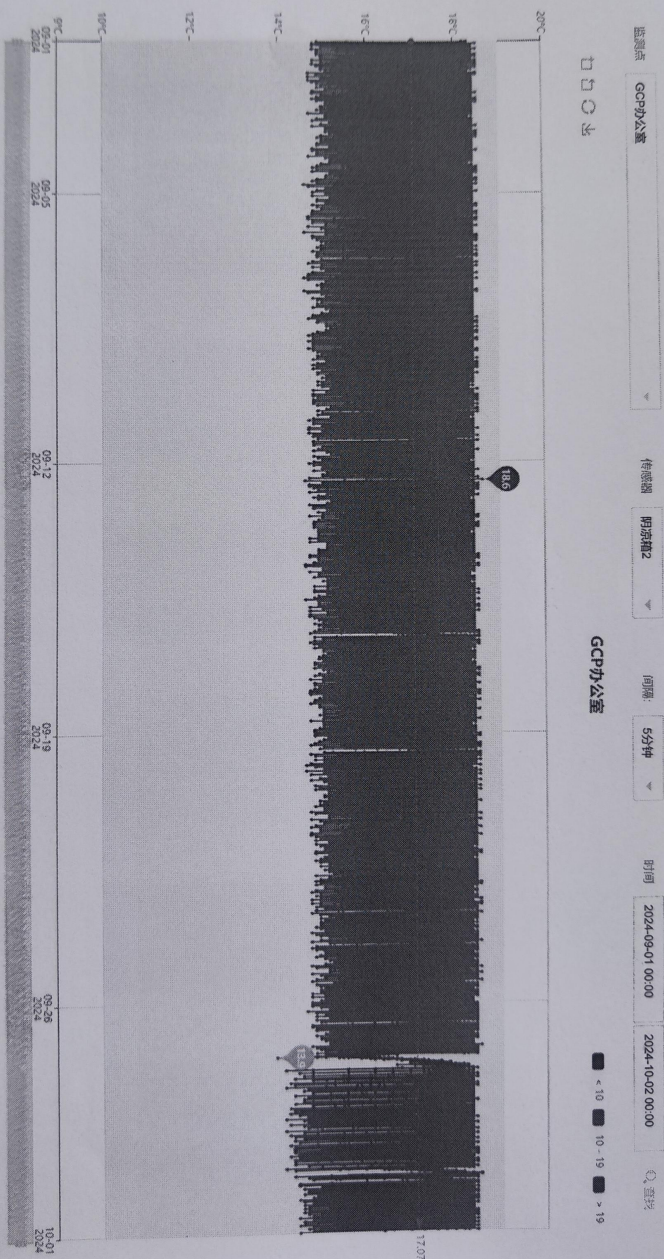

for the
English

阴凉柜 2

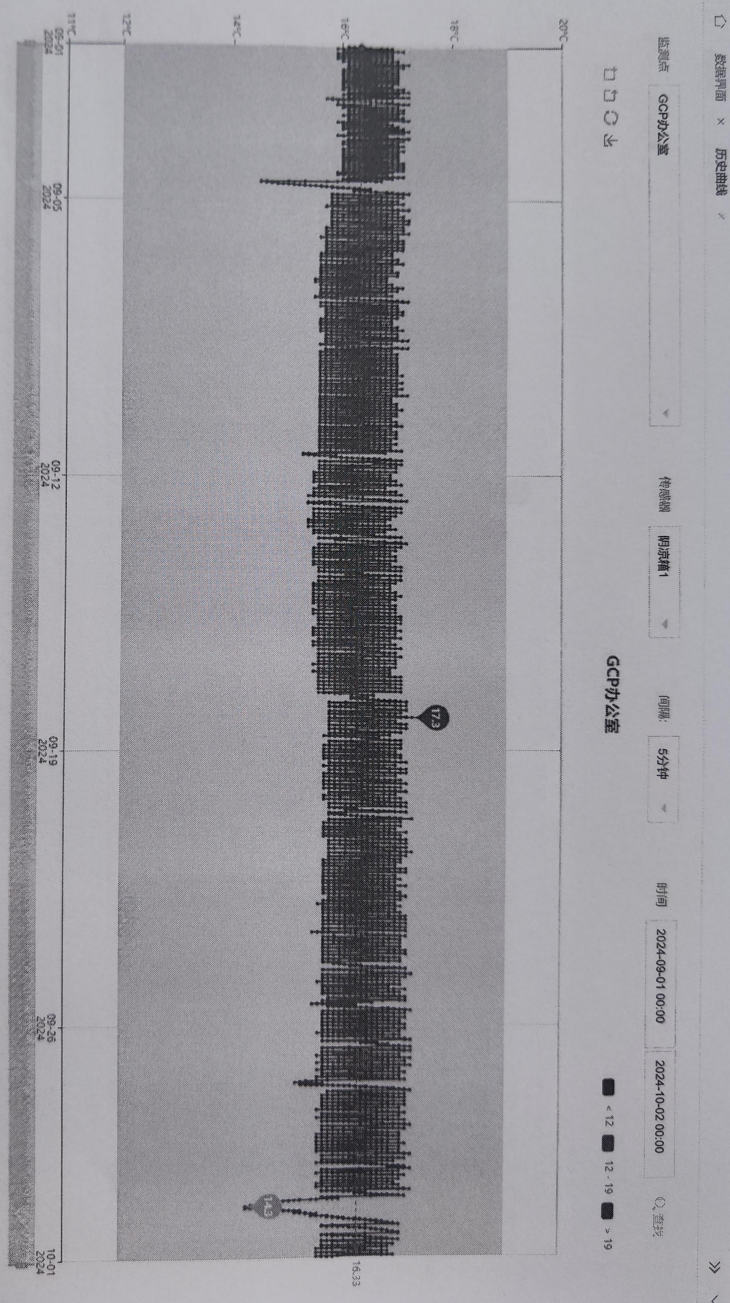

101400

阴凉柜 1