



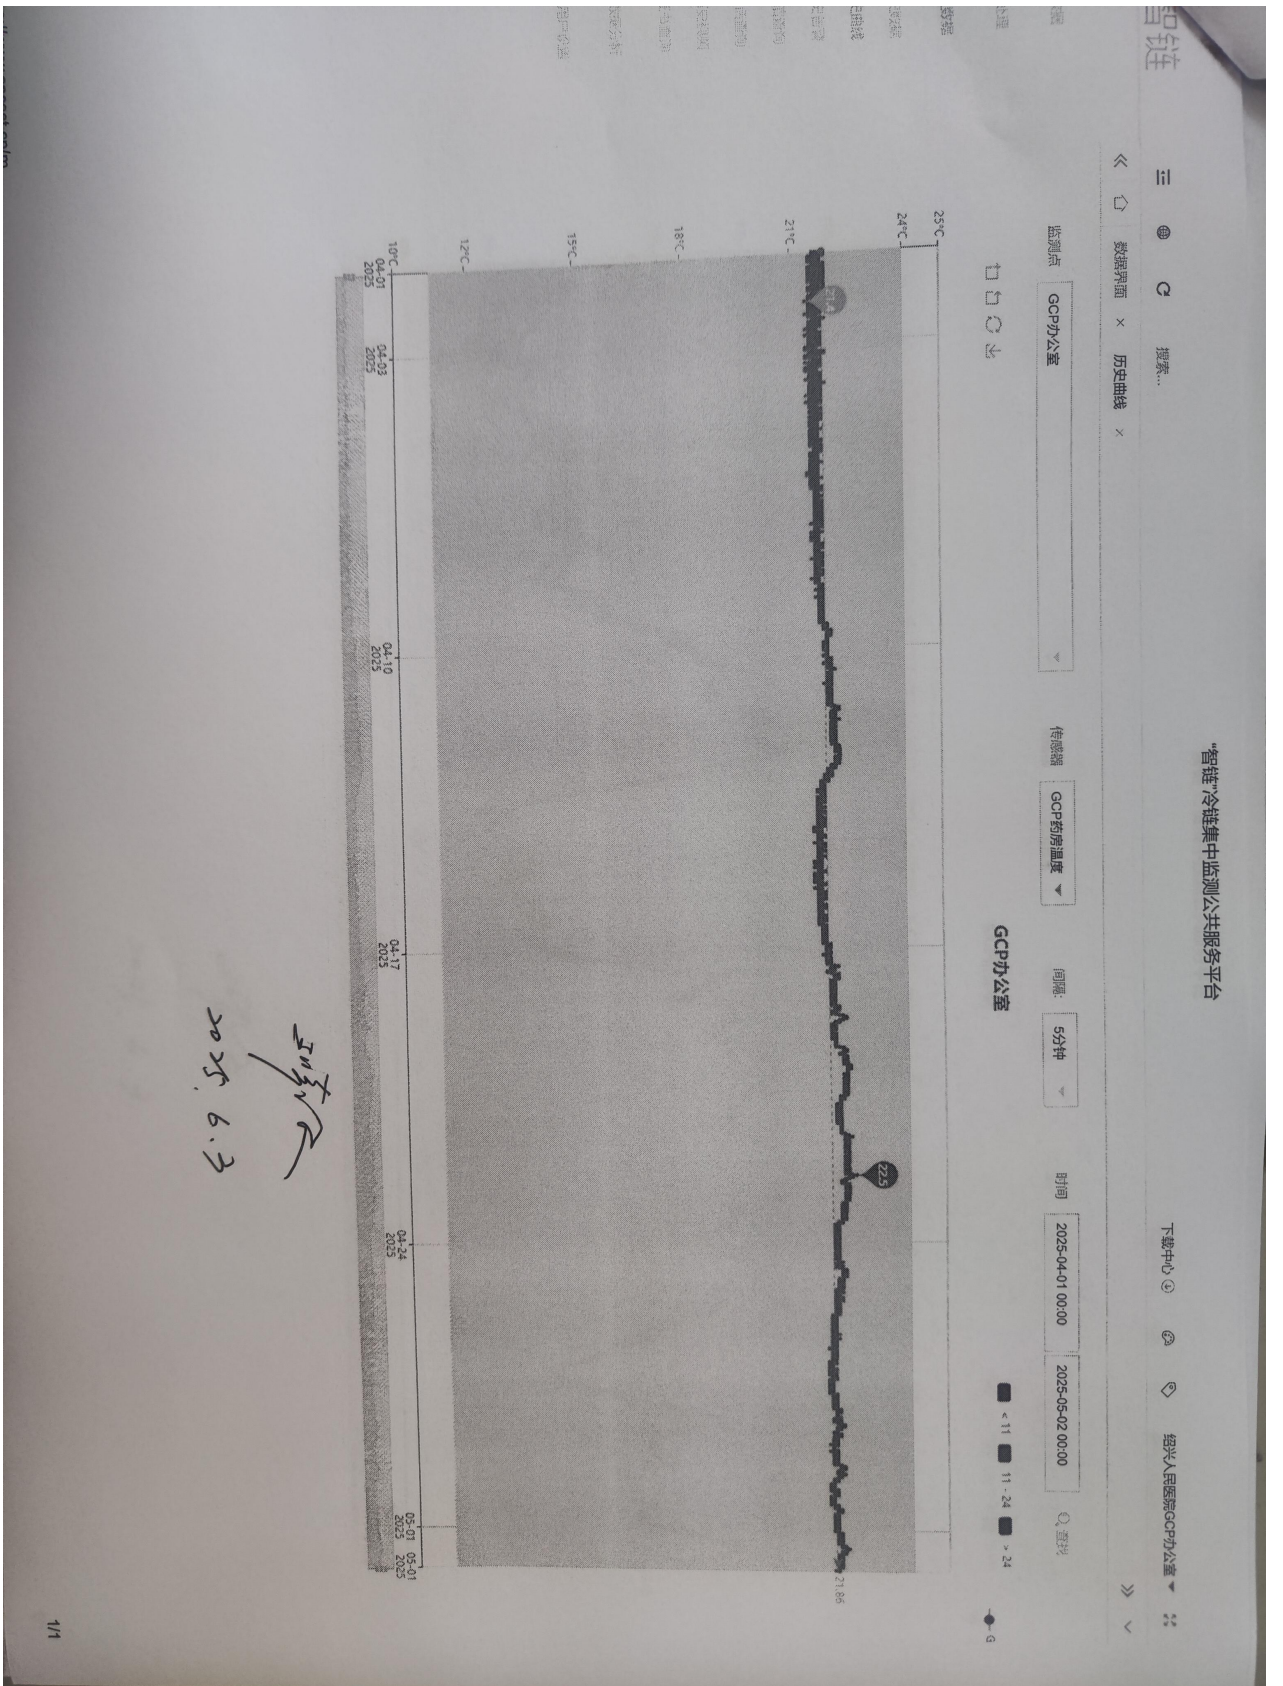

药房温度

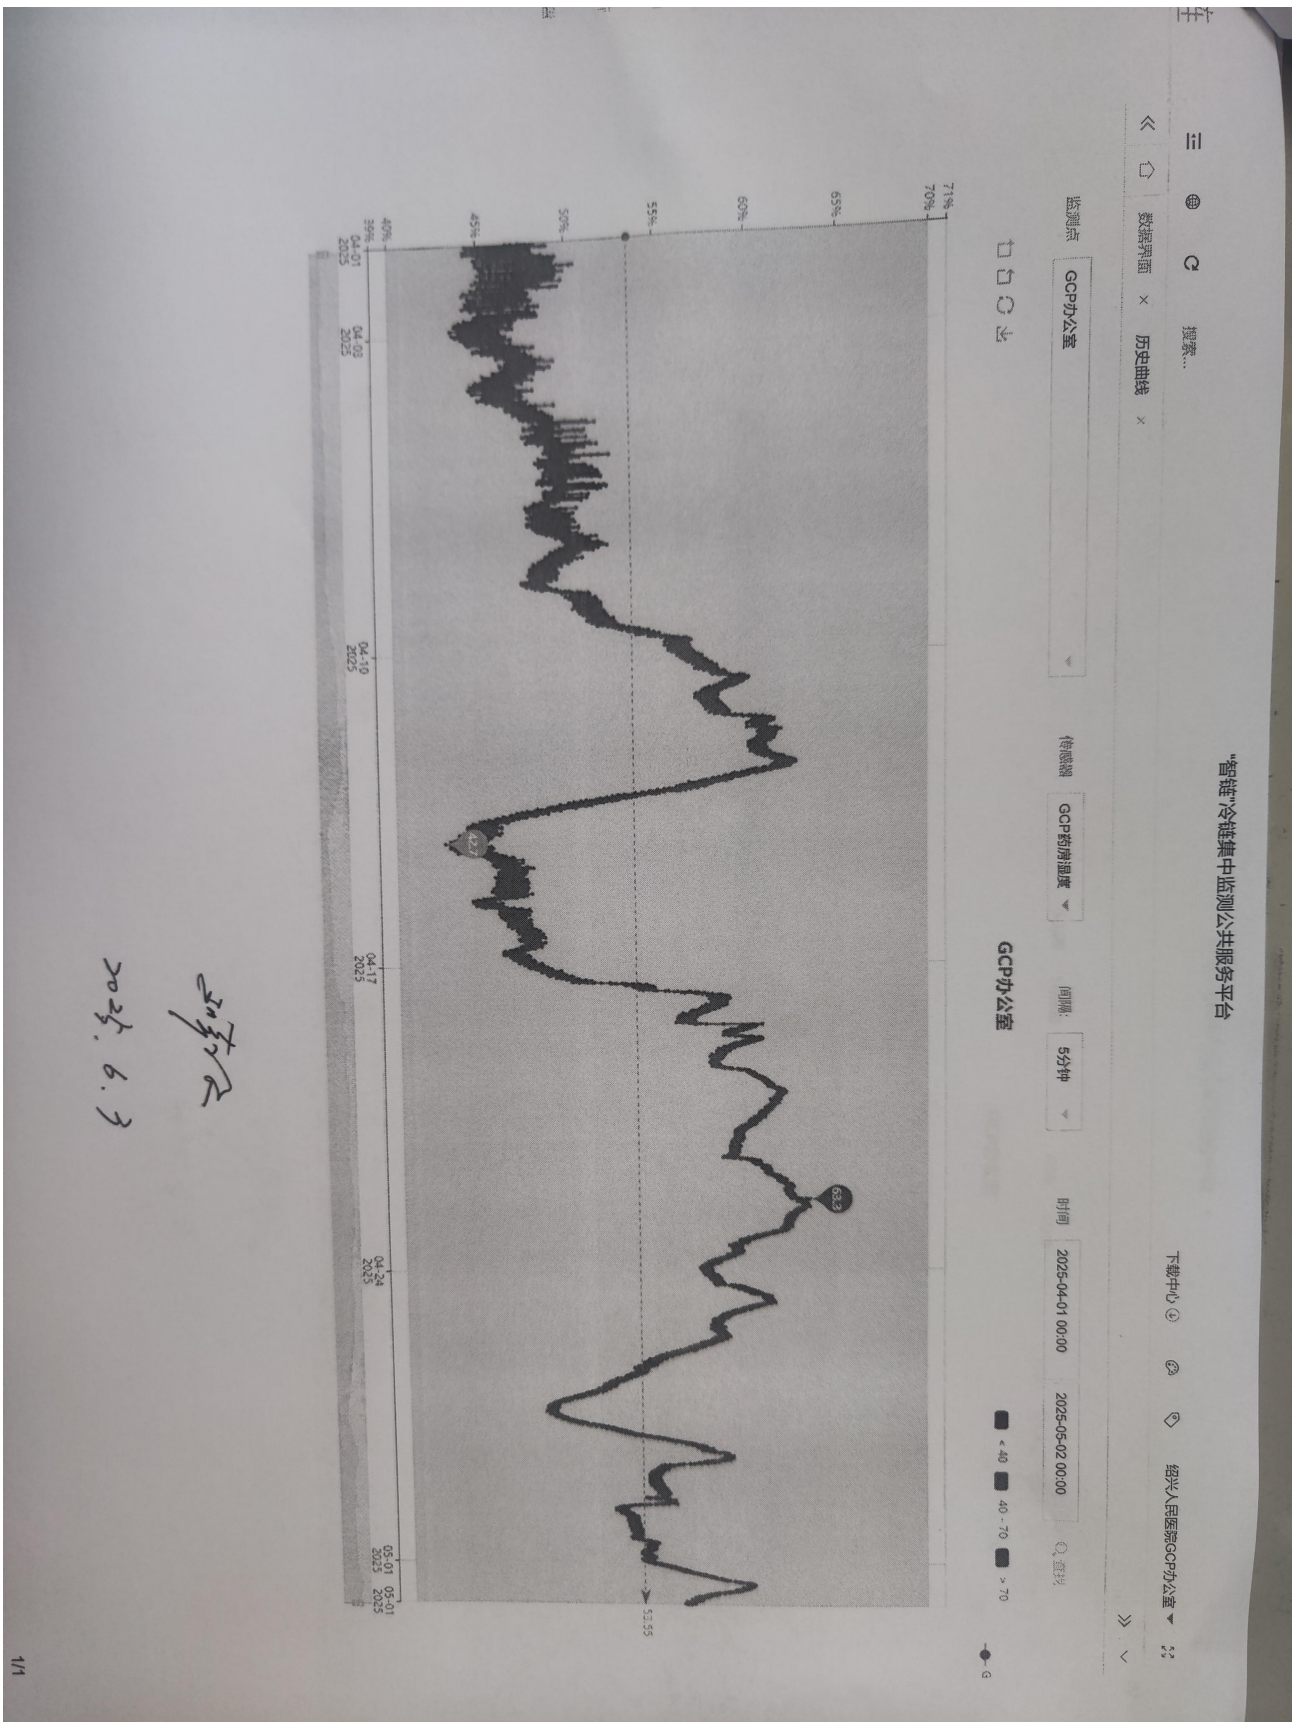

药房湿度

2025/6/3

“智链”冷链集中监测公共服务平台

智链

主页

实时数据

告警处理

历史数据

历史报警

历史曲线

历史报警

报警处理

报警处理

报警处理

报警处理

报警处理

报警处理

报警处理

数据界面 × 历史曲线 ×

监测点 GCP办公室

传感器 1号冰箱

间隔: 5分钟

时间 2025-04-01 00:00


2025-05-02 00:00

Q 查找

□ □ □ □


GCP办公室

< 3 3-7 7

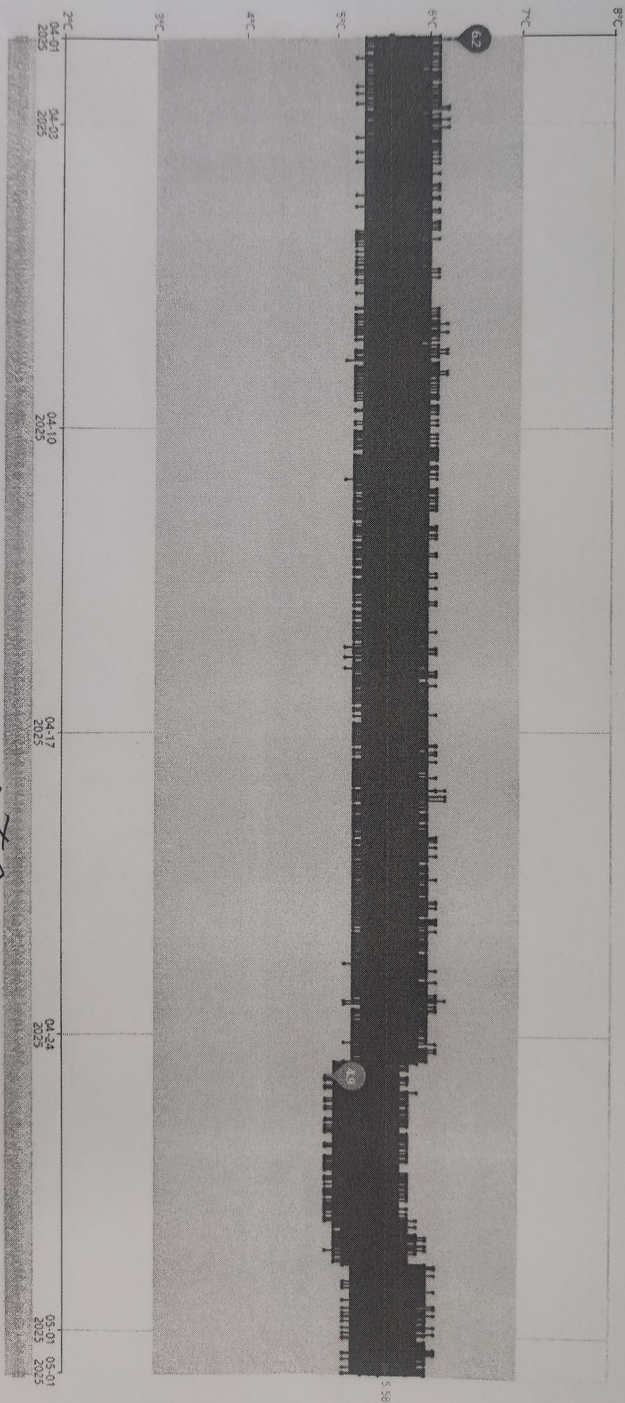


2025.6.3


1 号冰箱

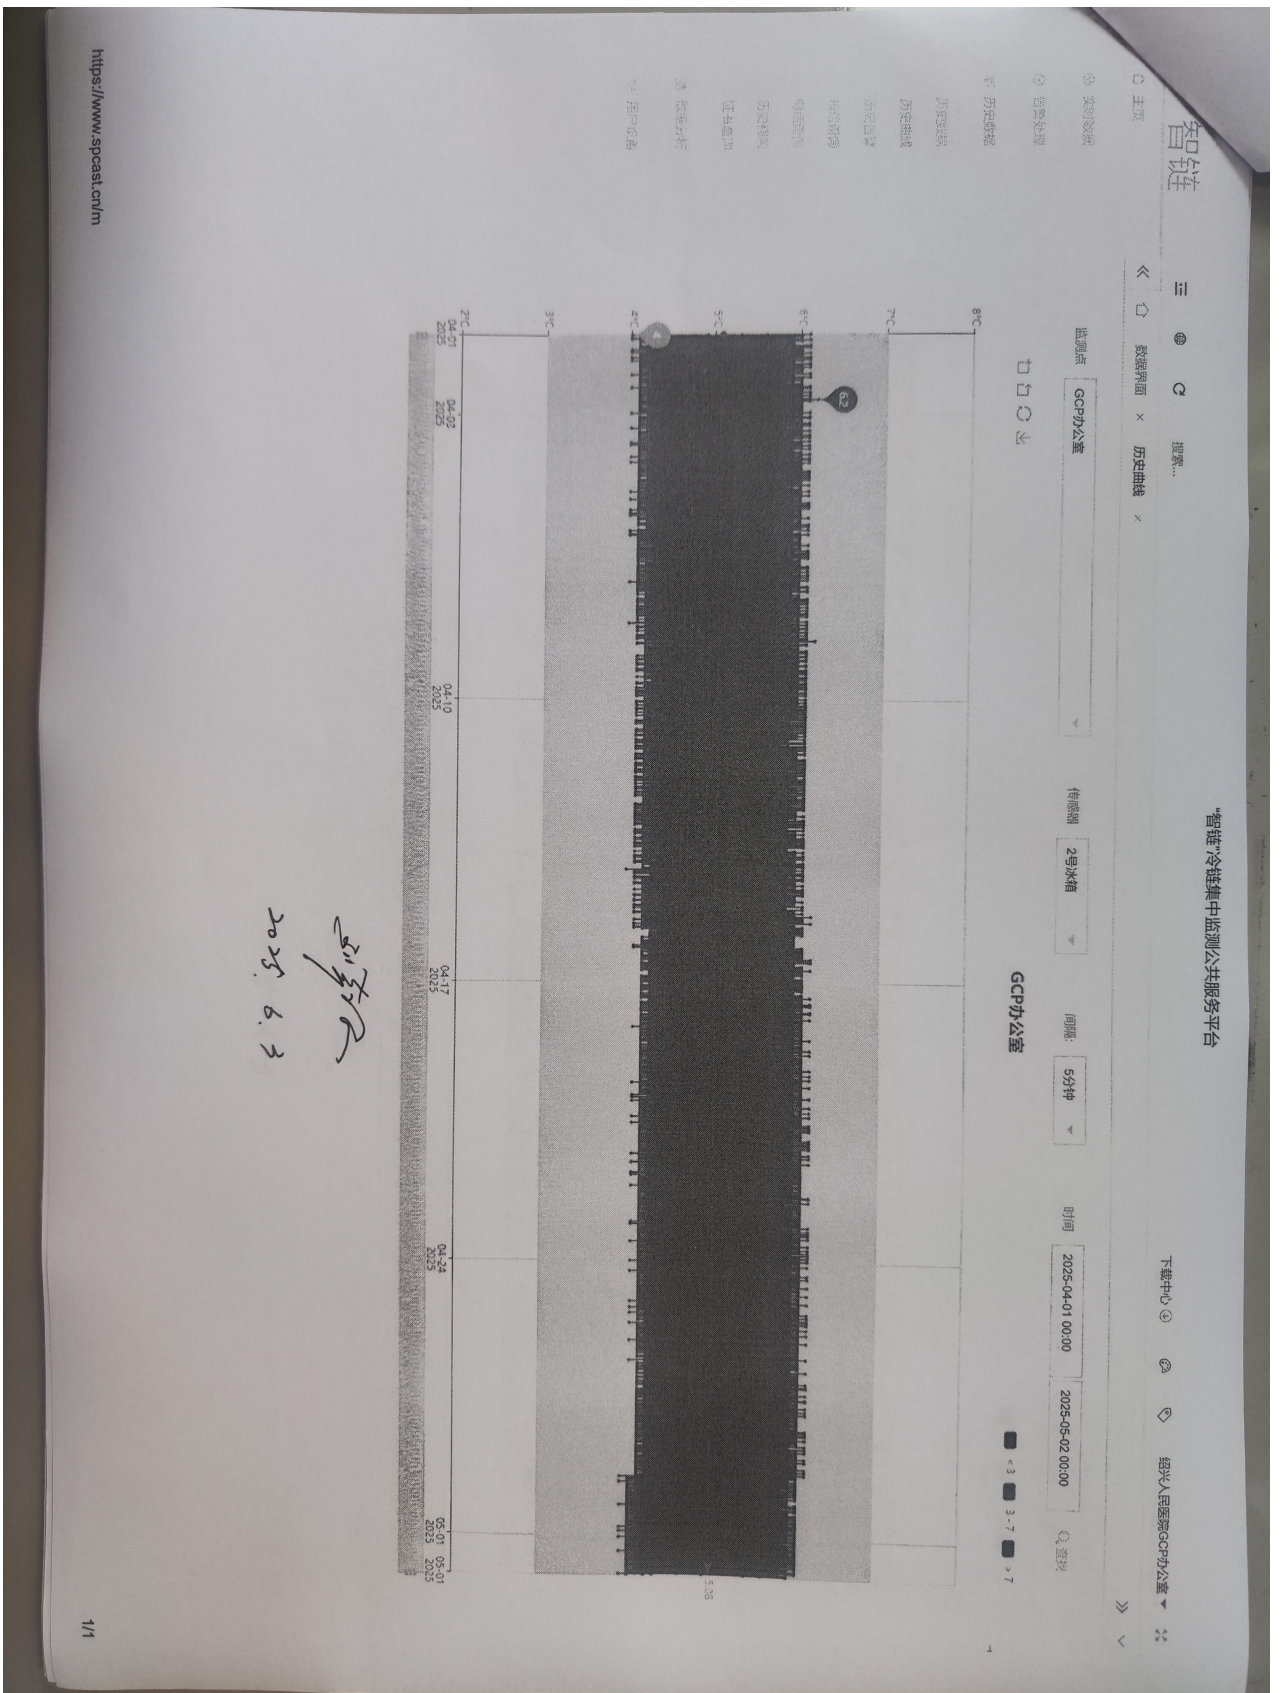

2 号冰箱

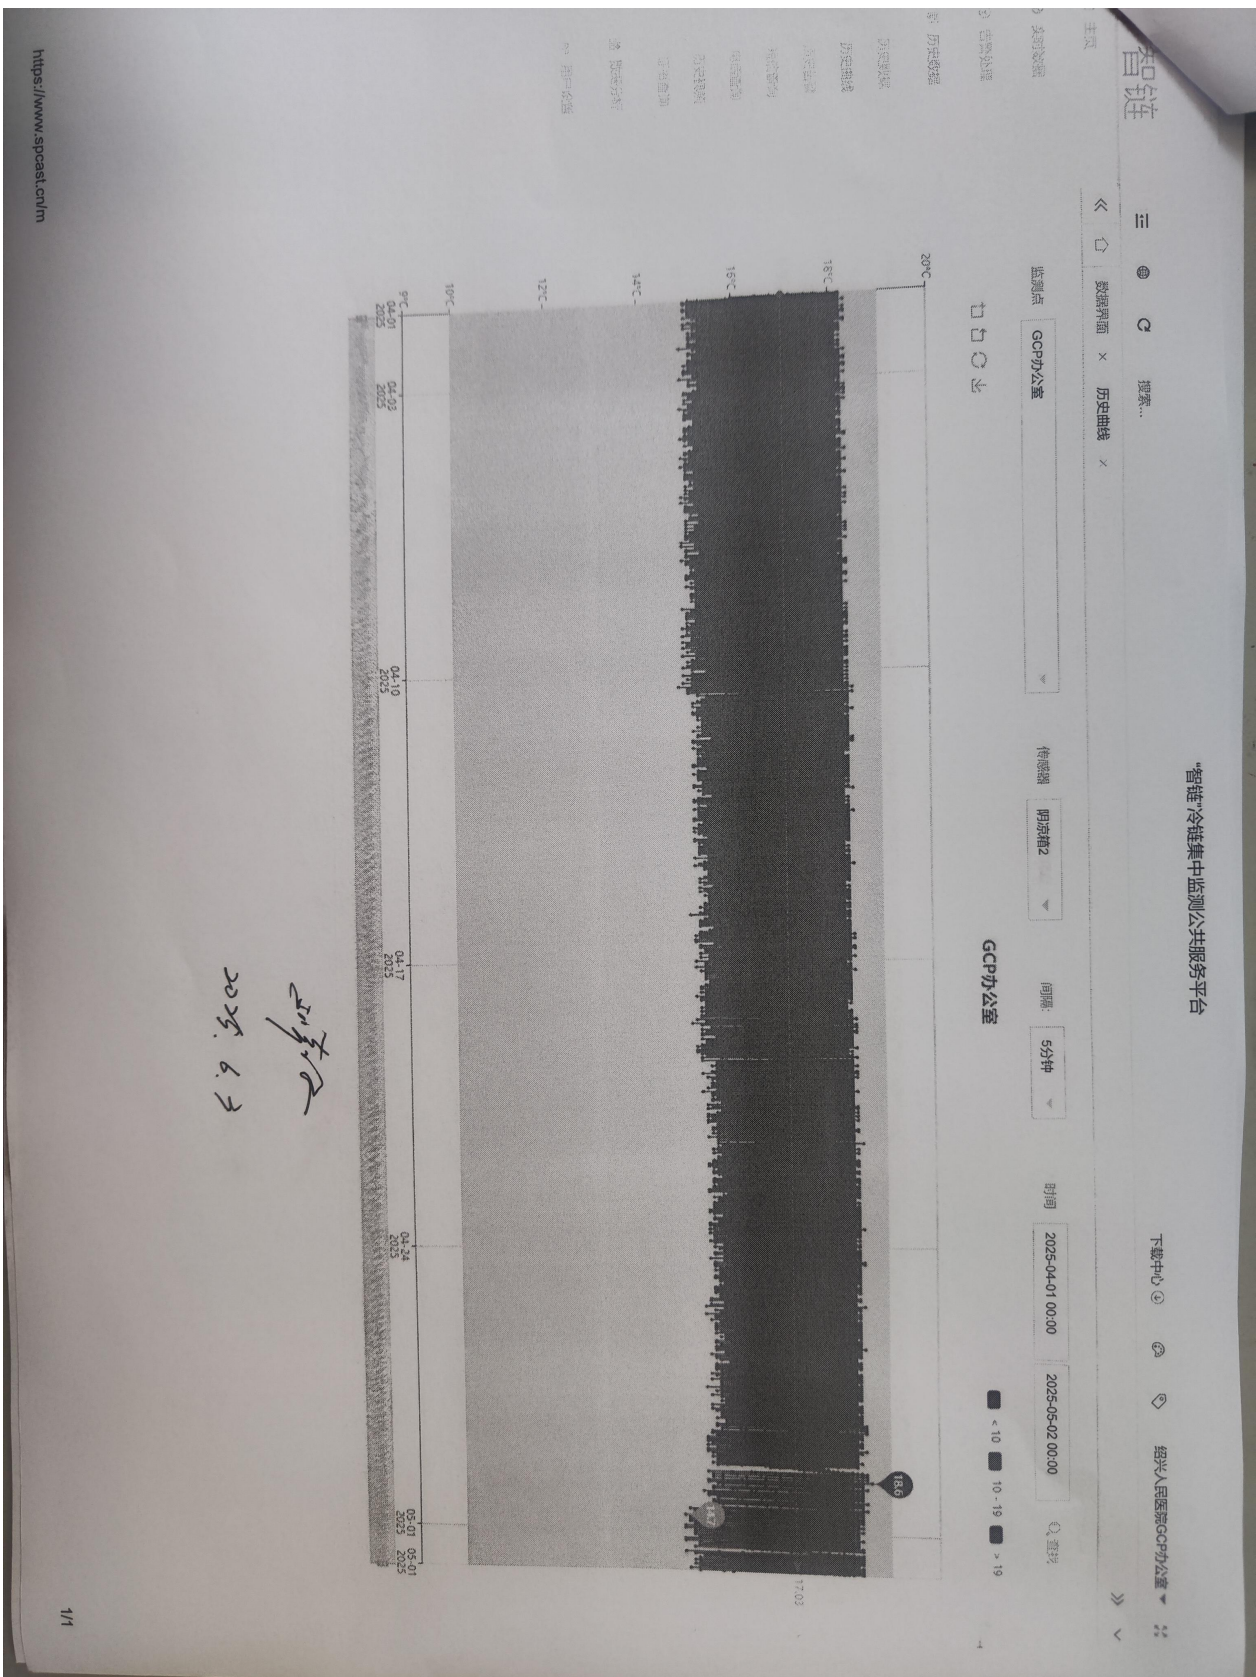

阴凉柜 2

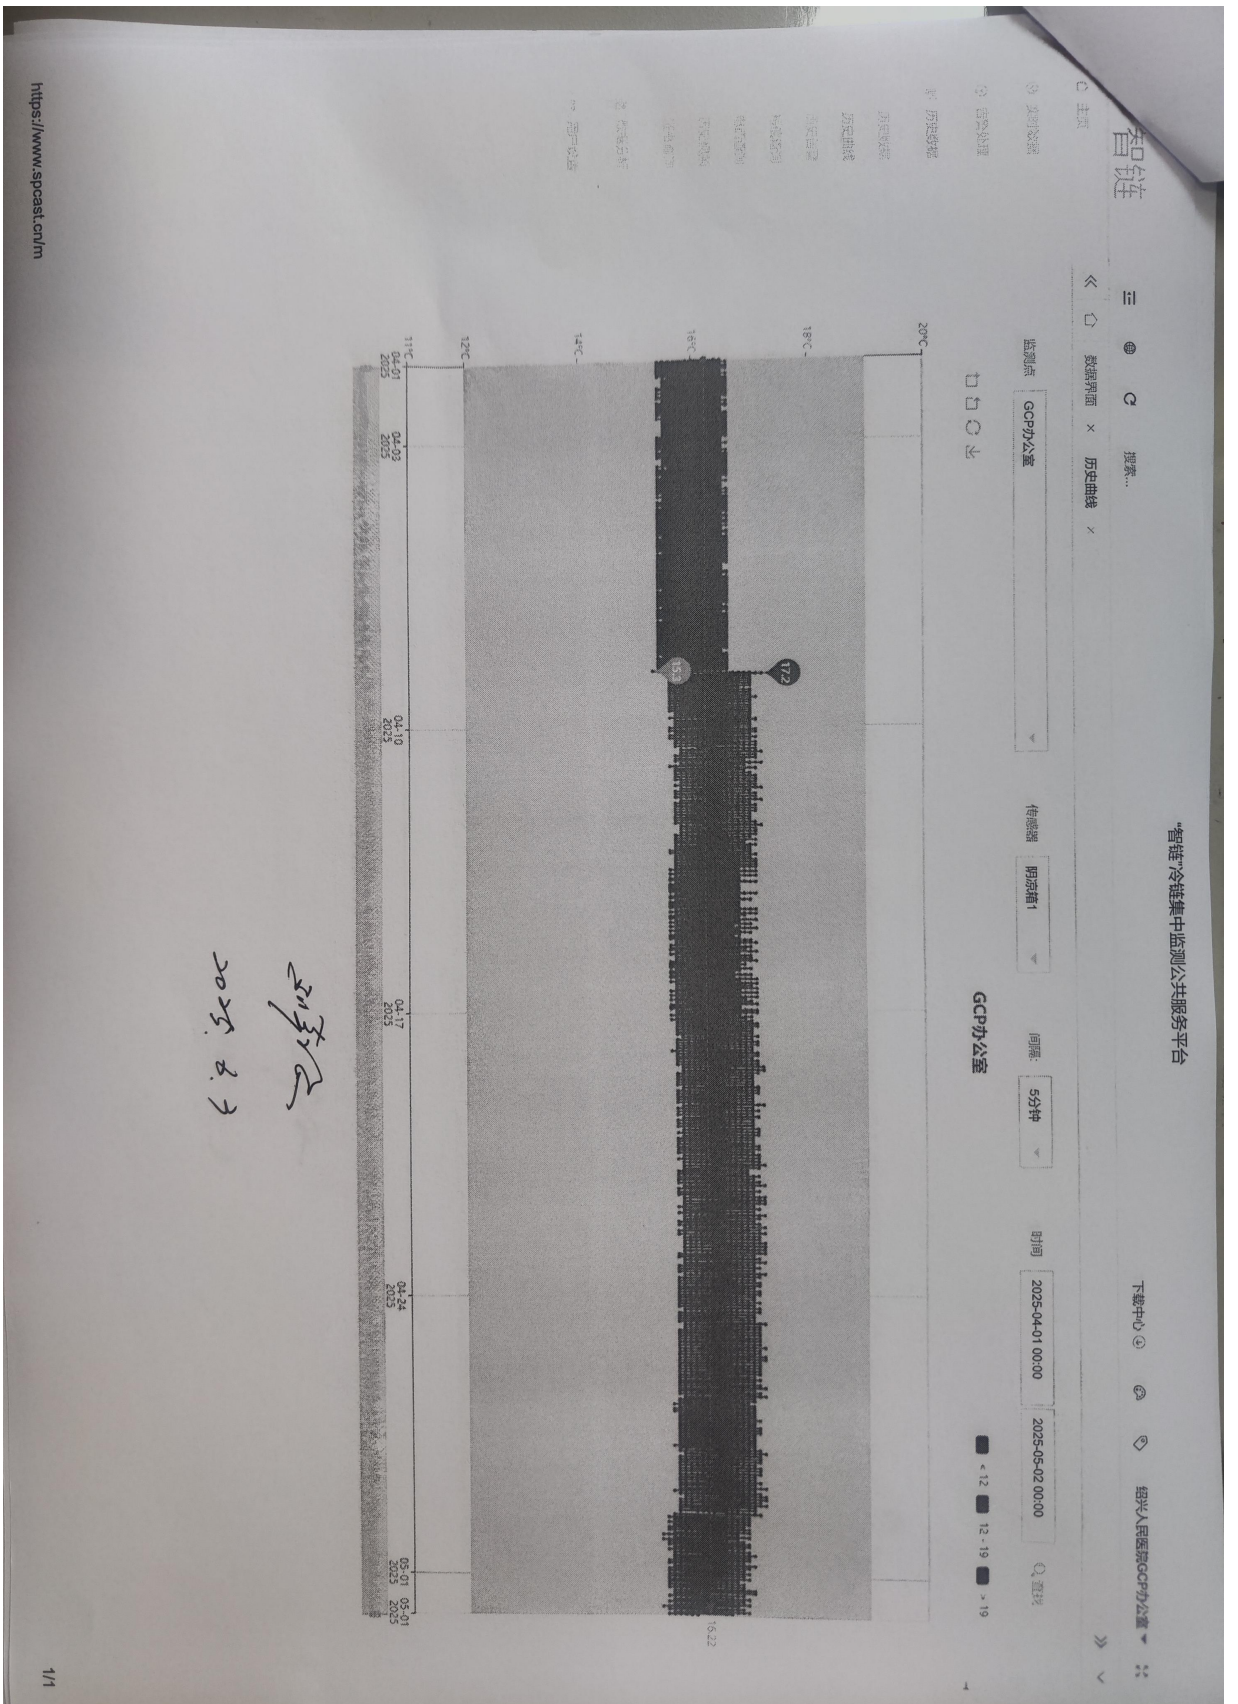

阴凉柜 1